

声学 & 振动测量仪器
ACOUSTICS & VIBRATION MEASURING INSTRUMENT

附、装箱清单

装箱清单		
名称	数量	备注
测试声源	1	
功放线	1	1.5m
合格证	1	
检测报告	1	
使用说明	1	

AWA5511 型 测试声源

使
用
说
明



杭州爱华仪器有限公司
HANGZHOU AIHUA INSTRUMENTS CO., LTD

2018 年 10 月


1、概述

AWA5511 型测试声源是一种以电动式扬声器为发声的声源，其性能指标符合 JJG 188-2017《声级计》7.1.3 节 h) 条对声源的总失真要求，符合 GB/T 12060.5-2011《声系统设备 第 5 部分：扬声器主要性能测试方法》要求。可作为消声箱自由场校正及声级计声信号检测使用等。

2、技术参数


- 额定阻抗：6Ω
- 额定输入功率：15W
- 最大长时输入电压：12Vrms
- 基准声压级下失真：84dB ， <3%
- 频率范围及响应：400Hz~20kHz, ±6dB
- 具有过压(12V)及过流(2A)保护（RMS）
- 外形尺寸：（W×D×H，mm）：158×158×158
- 质量：500g

3、结构特征

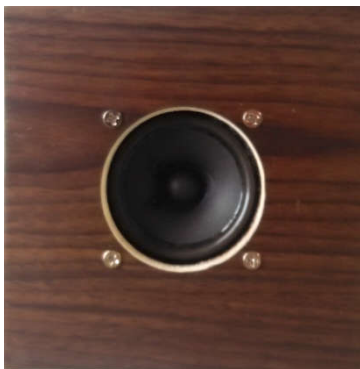

图片以实际为准

4、使用方法

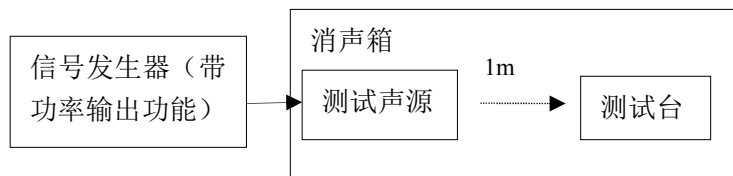

接线示意图

将测试声源置于消声箱内，并按上图连线，打开 AWA1650 信号发生器，调节按钮到所需输出电压幅值，此时声源开始发声，在测试台上放置相应仪器进行相关测试。